




30001342 - ND3804
IFU FUJI PLUS GC CAPSULES EEP

Read before use, carefully read the instructions for use.

GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the indications for use.



INDICATIONS FOR USE

- Direct pulp-based inlays, onlays, crowns and bridges
- Restoration of resin inlays, onlays, crowns and bridges
- Restoration of all ceramic inlays
- Restoration of high strength (zirconia based) all ceramic crowns and bridges
- Restoration of metal, ceramic and fiber posts

CONTRAINDICATIONS

- Direct pulp capping
- Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer

COMPOSITION

Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, initiator, pigment.
Liquid: Methacrylate, distilled water, polyacrylic acid, dimethacrylate, carboxylic acid, stabilizer.

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid ratio (g/g)	0.36 / 0.18
Mixing time (sec.)	10*
Working Time (23 °C / 73°F) (min., sec.)	200*
Setting Time(37 °C/99°F) (min., sec.)	415*

ISO 9917-2 Class 1, Luting Radio-opaque: Its radiopacity is equivalent to 2.1 mm or 210% aluminum. (The radiopacity of aluminum is comparable to dentin.)

1. TOOTH PREPARATION

- Prepare tooth in usual manner. For direct pulp capping, use calcium hydroxide.
- Clean the prepared teeth with pumice and water.
- Note: Apply GC Fuji PLUS CONDITIONER for 20 seconds using a cotton pellet or sponge.
- Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE. Best results are obtained when prepared teeth are kept moist (glazing).

2. RESTORATION PREPARATION

- Make sure that the restoration is pretreated and handed according to manufacturer's instructions.
3. CAPSULE MIXING AND MIXING
 - Before activation, shake the capsule or put its side on a hard surface to loosen the powder (Fig. 1).
 - The capsule should be activated just before mixing and use immediately.

- Ensure the plunger is fully pressed to avoid the incorrect mixing ratio of powder and liquid.
- The capsule should be activated just before mixing and used immediately.
- Immediately mix into a mixer (or an amalgamator) and mix for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 3).

Note: When using a rotational mixing device, it is recommended not to exceed the centrifuge option.

4. DISPENSING

- Immediately remove the mixed capsule from the mixer and apply it to the GC CAPSULE APPLIER.
- Make two clicks to prime the capsule (Fig. 4). To adjust the direction of the nozzle, hold the applicator with the capsule towards you and turn the capsule, push the plunger until it is fully depressed with the main body and hold it down for 2 seconds (Fig. 2).
- Extrude directly into the restoration (Fig. 5).
- To remove the used capsule, push the applicer release button.

5. CEMENTATION

- Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes from start of mixing at 23° (73°F). Higher temperatures will shorten working time.
- For more complex procedures requiring longer working time, it is recommended to refrigerate the capsules in the original aluminum foil.
- Start removing excess cement when the excess cement feels firm (Fig. 6).
- Finishing can be started 4 minutes 15 seconds after seating the restoration.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store the capsules in the original aluminum foil in a cool and dark place 4-25°C (39-77.0°F).

SHADES

Yellow A3 (Vita® shade)
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGE

50 capsules
Average contents per capsule: 0.36 g powder and 0.18 g (0.16 mL) liquid.
Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.19 mL.
Option: GC CAPSULE APPLIER (1 piece)

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCCA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride. It is not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with products containing Epinephrine as this may stain oral tissue.
- Do not use GC Fuji PLUS CAPSULE in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC Fuji PLUS CAPSULE from setting or bonding properly.
- This product is not indicated for filling or core build-up.
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <https://www.gc.dental/europe>

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory_gcc@gc-dental

Undesired effects - Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: <https://www.gcc-dental.europa>. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2024

Read before use, attentively read the instructions for use.

GC FUJI PLUS™ CAPSULE

RENTGENOPAKTRANTEN PODSIJELI GLAS-IONOMER ZA ČIMENTIRANJE U KAPSIJULI

Da se ispoljava samo od dentalnih lekara, spazivajući instrukciju za upotrebu.

INDIKACIJA ZA UPOTREBU

- Čimbenici za inleje, onleje, kroni i mostove s metalna osnovu.
- Čimbenici na kompozitni inleje, onleje, kroni i mostove.
- Čimbenici na keramični inleji, onleji, kroni i mostove.
- Čimbenici na izlizu keramični kroni i mostove od visokom otpornosti keramika (cirkonijum).
- Čimbenici na metalni, keramični i fibro-šifrove.

KONTRAINDIKACIJA

- Direktno pulpsko pokriće.
- Izbijanje upotreba na tozi produkt pri pacijenti s izvestni alergiji kim glas-ionomeri cement, metakrilatnen monomer ili metakrilatni polimer.

ČYBŤAV

Prac: Fluoro-alumino-silikatno staklo, Inicijator, Pigment Tenest: Metakrilat, Destilirana voda, Poliakrilat kiseline, Dimetakrilat, Karboksilovna kiselina

NASOKI ZA UPOTREBU

Сотношение прах/жидкость (г/г)	0,36 / 0,18
Время за смешивание (сек.)	10*
Время за работа (при 23 °С) (мин.сек.)	200*
Время за отверждение (37°С/99°F) (мин., сек.)	415*

ISO 9917-2 Клас 1 Чиментирање Радиопрозрачноста: Нејегова радиопрозрачноста е еквивалентна на 2,1 мм или 210% алуминиум. (Радиопрозрачноста на алуминиум е слична со тази на дентина.)

1. ПОДГОТОВКА ЗУБА

- Подгответе зуб по обичајни наачи. За директно пулно покритие на пулта, упозовајте калциум хидроксид.
- Почистете препаратите за 20 секунди со памучна вата. За оптимална адезива нанесете с памучен туфтер или памучна вата на припадниот помсту меѓу праќама с метална основа.
- Промийте обичајно со вода. Отстранете излишната влага чрез поливање с памучен туфтер или с лека въздушна струја. Не осушавате обичајно со ватна, туку етејте ја сувата со безмаслен ватен папир.

2. ПОДГОТВЕНЕ НА ВЪЗСТАВОВАНИЕТО
 - Преди активирање, третирајте капсулата или ја покувајте върху вървца поврhnост за да ја разгратите (Фиг. 1).
 - За активирање капсулата, натиснете капсула до пълно погъване на буталото в тилото и го задръжте до 2 секунди (Фиг. 2).

3. АКТИВИРАНЕ НА КАПСУЛИТЕ И СМЕСАВАНЕ
 - Преди активирање, разклатете капсулата или ја покувајте върху вървца поврhnост за да ја разгратите (Фиг. 1).
 - За активирање капсулата, натиснете капсула до пълно погъване на буталото в тилото и го задръжте до 2 секунди (Фиг. 2).

4. ДЪВКУВАНЕ
 - Уверете се, че пълтера е напълно потънал за да избегнете неправилно съотношение на смесване на праха и течността.
 - Капсулата трябва да се активира непосредствено преди смесване и я използвайте незабавно.

5. НАМАСНАВАНЕ
 - Безопасно извадете смесената капсула от смесителя и я поставете в GC CAPSULE APPLIER.
 - Щрапнете два пъти за да подготвите капсулата (Фиг. 4). За да регулирате посоката на излизане на пулпата, дръжте капсулата с капсулата към вас и завъртете тилото на капсулата.

6. НАМАСНАВАНЕ
 - Преди поставяне на капсулата, извадете апликатора с капсулата и извадете необходимото количество директно във въздушния поток (Фиг. 5).
 - За да свалите използваната капсула, натиснете бутона за освобождаване на апликатора. Завъртете капсулата и извадете я директно във въздушния поток (Фиг. 5).

7. ЦЕМЕНТАЦИЯ
 - Покрийте вътрешната повърhnост на възстановяването с достатъчно цимент и пулпата вървца.
 - Времето за работа е 2 минути от началото на смесването при 23°С (73°Ф). По-високи температури ще скъсят времето за работа.

8. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

9. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

10. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

11. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

12. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

13. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

14. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

15. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

16. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

17. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

18. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

19. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

20. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

21. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

22. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

23. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

24. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

25. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

26. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

27. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

28. ЗАКЛУЧКА
 - При по-сложни процедури, извадиха удължено време за работа, се препоръчва да охладите капсулите в оригиналната алуминиева опаковка с хладилник.
 - Приложите умерен натиск.
 - Започнете отстраняването на излишния цимент, когато стане твърд (Фиг. 6).
 - Финирането може да започне 4 минути и 15 секунди след поставянето на възстановяването.

Read before use, carefully read the instructions for use.

GC FUJI PLUS™ CAPSULE

RADIOPAKTRANTEN ZESILJENI SKLOIONOMERNI FIXAČNI CEMENT V KAPSIJULI

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ

- Čimbenici všech typů kovových inlejí, onlejí, korunek a mostků osnovu.
- Čimbenici kompozitních inlejí, onlejí, korunek a mostků.
- Čimbenici všech keramičnických inlejí, onlejí, korunek a mostků.
- Čimbenici všech korunek a mostků zhotovených z keramiky s vysokou pevností (na bázi zirkonia).
- Čimbenici kovových, keramičnických a fibro-šifrových.

KONTRAINDIKACE

- Prímé pulpské pokrývání.
- Nepoužití této metody produktu u pacientů se známou alergií na skloionomerní cement, metakrilátový monomer nebo metakrilátový polymer.

SŤAV

Prac: Fluoro-alumino-silikatno staklo, Inicijator, Pigment Tekutina: Metakrilat, Destilirana voda, Poliakrilat kiseline, Dimetakrilat, Karboksilovna kiselina

NASOKI ZA UPOTREBU

Сотношение прах/жидкость (г/г)	0,36 / 0,18
Время за смешивание (сек.)	10*
Время за работа (при 23 °С) (мин.сек.)	200*
Время за отверждение (37°С/99°F) (мин., сек.)	415*

ISO 9917-2 Трiод 1 Фиксање Радиопрозрачноста: Нејегова радиопрозрачноста е еквивалентна на 2,1 мм или 210% алуминиум. (Проѕирноста на алуминиум е слична со тази на дентина.)

1. ПРiПРАВА ЗУБА

- Подгответе зуб по обичајни наачи. За прекарвање директно пулпа, употребувајте хидрокси оксид.
- Очистете препаратите за 20 секунди со памучна вата. За оптимална адезива нанесете GC Fuji PLUS CONDITIONER на поврhnост на зуб и трајнајте од 20 секунди.
- Промийте обичајно со вода. Отстранете пребитошното вишок ватом трајноста немо јемне высуше въздушем (без злеје).

2. ПОДГОТВЕНЕ НА ВЪЗСТАВОВАНИЕТО
 - Преди активирање, третирајте капсулата или ја покувајте върху вървца поврhnост за да ја разгратите (Фиг. 1).
 - За активирање капсулата, натиснете капсула до пълно погъване на буталото в тилото и го задръжте до 2 секунди (Фиг. 2).

3. АКТИВИРАНЕ НА КАПСУЛИТЕ И СМЕСАВАНЕ
 - Преди активирање, разклатете капсулата или ја покувајте върху вървца поврhnост за да ја разгратите (Фиг. 1).
 - За активирање капсулата, натиснете капсула до пълно погъване на буталото в тилото и го задръжте до 2 секунди (Фиг. 2).

4. ДЪВКУВАНЕ
 - Уверете се, че пълтера е напълно потънал за да избегнете неправилно съотношение на смесване на праха и течността.
 - Капсулата трябва да се активира непосредствено преди смесване и я използвайте незабавно.

5. НАМАСНАВАНЕ
 - Безопасно извадете смесената капсула от смесителя и я поставете в GC CAPSULE APPLIER.
 - Щрапнете два пъти за да подготвите капсулата (Фиг. 4). За да регулирате посоката на излизане на пулпата, дръжте капсулата с капсулата към вас и завъртете тилото на капсулата.

6. НАМАСНАВАНЕ
 - Преди поставяне на капсулата, извадете апликатора с капсулата и извадете необходимото количество директно във въздушния поток (Фиг. 5).
 - За да свалите използваната капсула, натиснете бутона за освобождаване на апликатора. Завъртете капсулата и извадете я директно във въздушния поток (Фиг. 5).

7. ЦЕМЕНТАЦИЯ
 - Покрийте вътрешната повърhnост на възстановяването с достатъчно цимент и пулпата вървца.
 - Времето за работа е 2 минути от началото на смесването при 23°С (73°Ф). По-високи температури ще скъсят времето за работа.

- 8.

Пред použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. **SK**

GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RADIOOPAKY ZOSILNENÝ SKLONDOMERNÝ FIXAČNÝ CEMENT V KAPSULÁCH

Na použitie len zbrným lekárom v indikáciách na použitie.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

1. Cementovanie všetkých typov kovových inlejev, onlejev, korúniek a 2. Cementovanie všetkých typov živýchcových inlejev, onlejev, korúniek a mostikov.
2. Cementovanie všetkých keramikých inlejev, onlejev, korúniek a mostikov.
3. Cementovanie všetkých keramikých inlejev, onlejev, korúniek a mostikov vyrobených z keramiky s vysokou pevnosťou (na báze zirkónia).
4. Cementovanie kovových a keramikých záporov a záporov vyrobených sklenenými vláknami (fiber posts).

KONTRAINDIKÁCIE

1. Priame prekrytie pulpy.
2. Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známu alergiou na sklondomerný cement, metakrylátový monoméer alebo metakrylátový polymér.

ZLOŽENIE

Prášok: Fluor-hinito-silikátové sklo, Inicialtor, Pigment Kvapalina: Metakrylát, Destilovaná voda, Kyselina polyakrylová, Dimetakrát, Kyselina karboxylová

NÁVOD NA POUŽITIE

Razmerie/tekutina pomer (g/g)	0,36 / 0,18
Čas miešania (sek.)	10*
Delovni čas (pri 23°C) (min., sek.)	200*
Kövénemesiaq (37°C/99°F) (min., sek.)	415*

ISO 9917-2 triedy 1, Cementovanie Radiopáky. Njegová radioopaznosť je enaka 2,1 mm ali 210% hlinika. (Radioaktívna hlinika je porovnateľná s dentinóm.)

1. PRIPRAVA ZUBA

- a) Pripraviť zub bežným spôsobom. Na prekrytie priame prekrytie pulpy použite hydroxid väpnatý.
- b) Vyčistiť preparovaný zub netou a vodou.

Zoznamka:

Vodou očistite alebo spongiou aplikujte GC Fuji PLUS CONDITIONER po dobu 20 sekúnd.

c) Dôkladne opláchnite vodou. Prebytok vlhkosti odstráňte vatou tampónom alebo vysušte miernym výfukom neteprým vzduchom. NEPRESUŠUJTE. Najlepší výsledok sa dosiahne, keď sa preparovaný povrch javí vlhky (lesklý).

2. PRIPRAVA NÁHRADY

- a) Zmes náhrady je zhotovená a predpripravená podľa inštrukcií výrobcu.

3. AKTIVÁCIA KAPSULE A MIEŠANIE

- a) Da aktivovať kapsulu pripraviť bat do konca v kapsule, da je poranan v očíhš kapsule in držte 2 sekundy (Silka 3).

c) Kapsulu aktivujte upitým zariadením piesta do hlavného telesa kapsule a podržte ju 2 sekundy (obr. 2).

Zoznamka: Ak použivate rotujúci zmiešavaci prístroj, nepoužívajte motocyklové rotujúce.

4. DÁVKOVANIE a) Okamžite vytvorte kapsulu a vložte ju do GC APPLIKAČNÝCH KLEŠŤÍ. Dôkladne stlačte, potom je materiál v kapsuli pripravený na aplikáciu (obr. 4). Nátencie trysky môžu zmeniť tak, že pridržie aplikátor proti sebe a očísate tieto zariadenia.

b) V prípade potreby môžete kapsulu vyčistiť a vyfúkate ju do sucha. Na vybratie pulpy kapsule stlačte tlačidlo na aplikátore. Kapsulu očistite a vyfúkate smerom hore.

5. CEMENTOVANIE a) Pokyte určitý povrch náhrady dostatočnými dĺžkami pracovného cementu a okamžite ju nasadte. Pracovný čas od začiatku miešania je 2 minuty pri 23°C (73°F). Vyššia teplota skracuje pracovný čas.

Zoznamka:

Čas, sa doporučuje uchovávať kapsule v chladničke, zabalené v originálnej alumínovej fólii.

b) S každou obdelavo lahko začne 4 minuty in 15 sekúnd po strditi restaracije.

c) Odstráňte prebytočný cement vo chvíli, keď je jeho konzistencia „gumovitá“ (obr. 6).

d) Opracovne môžete začať 4 minuty 15 sekúnd po usadení náhrady.

SKLADOVANIE

Pre zachovanie optimálnych vlastností je doporučované skladovať kapsule v originálnej alumínovej fólii na tmavom a chladnom mieste 4-25°C (39-77,0°F).

ODTENE

A3 (Vita® odlieh) Vita® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemcko.

BALENIE 50 kapsul Povrchová vzebnia kapsule: 0,36 g práhu in 0,18 g (0,16 ml) tekočine Minimálny neto volumen zmesného cementu na kapsulu: 0,19 ml. Mnozost: GC CAPSULE APPLIER (1 kosa)

OPOZORLIE 1. V prípade stitka materiálu s tlou v ústnu vodnici ali s kožo, ga takoj odstráňte z gobo ali vato namočenom v alkoholi. Sprerte z vodo. Za prepracovanie stikov lahko uporabte koferdam in/ali izolirane operacijske ploky s pomočjo COCOA BUTTER-a.

2. V prípade kontaktu s očami ihmed vypláchnite vodou a vyfúkate lekársku pomoc.

3. GC Fuji PLUS CONDITIONER obsahuje 2% chloridu železitého. Neodporúča sa kombinovať GC Fuji PLUS CONDITIONER s produktami obsahujúcimi epinefrín, pretože môže dôjsť k zarúbreniu krvi v ústnu dutinu.

4. Nepoužívajte GC Fuji PLUS CAPSULE v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, pretože eugenol môže brániť náležitému tuhnutiu a naviazaniu materiálu.

5. Tento produkt nie je určený pre výplne alebo dntáv.

6. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte použitie výrobku a vyhľadajte lekára.

7. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.

Nekateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Někateré výrobky uvádzané v návodoch na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Пред употребo предварительно прeчитайте инструкцию на употребo. **SL**

GC Fuji PLUS™ CAPSULE

RADIOOPAKY OJACANI STEKLASNO IONOMERNI CEMENT ZA LEPLJENJE V KAPSULAH

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

INDIKACIJE ZA UPORABO

1. Cementiranje kovinskih inlejev, onlejev, prevlek in mostikov.
2. Cementiranje onlejev, onlejev, prevlek in mostikov.
3. Cementiranje polno keramičnih inlejev, onlejev, korúnok i mostikov.
4. Cementiranje kovinskih (cikronovih) polno keramičnih prevlek in mostikov.
5. Cementiranje močnih, keramičnih ili vlnačičkih.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno krija pulpe.
2. Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na sklondomerni cemente, metakrilatne monomere ali metakrilatne polimere.

SESTAVA

Prah: Flor-alumini silikato steklo, Inicialtor, Pigment Tekočina: Metakrilat, Destilirana voda, Poliakrična kiselina, Dimetakrilat, Karboksilna kiselina

NAVODILA ZA UPORABO

Razmerje prah / tekočina (g/g)	0,36 / 0,18
Čas mešanja (sek.)	10*
Delovni čas (pri 23°C) (min., sek.)	200*
Kövénemesiaq (37°C/99°F) (min., sek.)	415*

ISO 9917-2 Klasa 1, Cementiranje Radiopáky. Njegová radioopaznost je enaka 2,1 mm ali 210% hlinika. (Radioaktívna hlinika je porovnateľná s dentinóm.)

1. PRIPRAVA ZOBA

- a) Zób pripravite na običajen način. Za zakobito direktna krija pulpe uporabite kalcijski hidroksid.
- b) Pripraviť zub očistite s plovcem in vodo.

Návod: Za optimálno adhezijo na pripravljeno zobno površino naneste GC Fuji PLUS CONDITIONER za 20 sekúnd s pomočjo vnetre kroglice ali špičice.

c) Možno sperite z vodo. Viške vode odstranite s pomočjo vatne kroglice ali navlažite z zrakov, ki ne vsebuje oia. NE IZSUŠITE. Za najboljšie rezultate naj bo pripravljena površina vlažna (svetlozlatá).

2. RESTAVRACIJA PREPARACIJE Restaravaci obravnave inlejev a nje v skladu z navodili proizvajalca.

3. AKTIVACIJA KAPSULE I MIEŠANJE a) Pre aktiviranje, protesi ili jednom stranom udariti o tvrdú površinu kako bi se oslobodio prah (Silka 1).

b) Da aktivirati kapsulu pripraviť bat do konca v kapsulo, da je poranan v očíhš kapsule in držte 2 sekundy (Silka 2).

Opozorilo: 1) Zagotovite da je bat pritisnjen do konca v kapsulo, da se izogne nepravilnemu razmerju prah i tekočine.

2) Kapsulu treba aktivirati tek neposredno pre mešanja i obojima.

c) Tako j u vstavite v mešalac (ili amalgamator) i mešajte 10 sekundi (+/- 4.000 obratov) (Silka 3).

Zoznamka: Se uporabljate rotacijski mešalec, uporaba centrifuge ni priporočljiva.

4. DOZIVANJE a) Zamešano kapsulo takoj vzemite iz mešalca i ujo vstavite v GC CAPSULE APPLIER.

b) Naredite kapsulo, tako da pripravite kapsulo (Silka 4). Za prilagoditev usnja lahko pridržite nastavke s kapsulo proti vam in obrnite telo kapsule.

c) Cement istisniti direktno u preparaciju (Silka 5).

d) Za odstranjenje korišćene kapsule pritisniti gumbo za oslobodjenje na aplikatoru. Okrenuti kapsulu i povući prema gore.

5. CEMENTOVANIE a) Notranje površine restaracije prevažite z zadostno količino cementa i takoj namestite na krm. Delovni čas je 2 minuti od začatka mešanja pri 23°C (73°F). Vyššia teplota skracuje radno vreme.

b) Zoznamka: Kompleksnejši postopki zahtevajo daljšo radno vreme, preporučuje čuvati kapsule u frižideru i originalnoj alumínovoj foliji.

c) Zadržite zmešani pritisk.

d) Čas odstranite zaprte kapsule, ako je postojano gumjasti (Silka 6).

e) S každo obdelavo lahko začne 4 minuty in 15 sekúnd po strditi restaracije.

SHRANJEVANJE

Za optimalen rezultat pripravljajte kapsule shranjvati v originalni alumínovoj foliji ali hladnom i tamnom prostoru 4-25°C (39-77,0°F).

BARVA

Rumena Zuba (Vita® barva) Vita® je tovarniški zaščitni znak Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemčija.

PAKIRANJE

50 kapsul Povrchová vzebnia kapsule: 0,36 g práhu in 0,18 g (0,16 ml) tekočine Minimálny neto volumen zmesného cementu na kapsulu: 0,19 ml. Mnozost: GC CAPSULE APPLIER (1 kosa)

OPOZORLIE

1. V prípade stitka materiálu s tlou v ústnu vodnici ali s kožo, ga takoj odstráňte z gobo ali vato namočenom v alkoholi. Sprerte z vodo. Za prepracovanie stikov lahko uporabte koferdam in/ali izolirane operacijske ploky s pomočjo COCOA BUTTER-a.

2. V prípade kontaktu s očami ihmed vypláchnite vodou a vyfúkate lekársku pomoc.

3. GC Fuji PLUS CONDITIONER vsebuje 2% železov klorid. Uporaba radiopáky s kombinacijo GC Fuji PLUS CONDITIONER s produktami obsahujúcimi epinefrín, pretože môže dôjsť k zarúbreniu krvi v ústnu dutinu.

4. Nepoužívajte GC Fuji PLUS CAPSULE v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, pretože eugenol môže brániť náležitému tuhnutiu a naviazaniu materiálu.

5. Tento produkt nie je určený pre výplne alebo dntáv.

6. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte použitie výrobku a vyhľadajte lekára.

7. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Někateré výrobky označené v predných návodoch na použitie sú alebo môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obzornejšie s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.gc.dental/europe

Môžete ich tiež získať od svojho zastopníku.

Pre употребo pažljivo pročítajte uputstvo. **SR**

GC Fuji PLUS™ CAPSULE

OJACAN RENDGENSKI VIDLJIV GLASJONOMER CEMENT ZA CEMENTIRANJE U KAPSULAMA

Samo za stručno stomatološku upotrebu u indikacijama za upotrebu.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

1. Cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova sa metalnom mostovcu.
2. Cementiranje kompozitnih inleja, onleja, krunica i mostova.
3. Cementiranje punih keramičnih inleja.
4. Cementiranje kovinskih (cikronovih) krunica i mostova (sa osnovom iz cikronjuna) velike čvrstoće.
5. Cementiranje metalnih, keramičnih ili fiber kočica.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Izbegeti sad upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na glasonomer cemente, metakrilatne monomer ili metakrilatne polimere.

SASTAV

Prah: Floro-alumino-silikatno staklo, Inicialtor, Pigment Tekočina: Metakrilat, Destilirana voda, Poliakrična kiselina, Dimetakrilat, Karboksilna kiselina

UPUTSTVO ZA RAD

Odnoš prah / tekočina (g/g)	0,36 / 0,18
Vreme mešanja (sek.)	10*
Delovni vreme (pri 23°C) (min., sek.)	200*
Serletenje Suresi (37°C/99°F) (min., sek.)	415*

ISO 9917-2 Klasa 1, Cementiranje Radiopáky. Njegová radioopaznost je ekvivalentna 2,1 mm ili 210% aluminijuma. (Radioopaznost aluminijuma je uporedivna s dentinom.)

1. PRIPRACIJA ZUBA

- a) Zub pripremiti na običajen način. Za prekrivanje direktno prekrivanje pulpe koristiti kalcijski hidroksid.
- b) Pripremiti zub očistiti s plovcem i vodom.

Návod: Za optimálno adheziju na pripravljeno zobno površino naneste GC Fuji PLUS CONDITIONER za 20 sekúnd s pomočjo vatne kroglice ali špičice.

c) Možno sperite z vodo. Viške vode odstranite s pomočjo vatne kroglice ali navlažite z zrakov, ki ne vsebuje oia. NE IZSUŠITE. Za najboljšie rezultate naj bo pripravljena površina vlažna (svetlozlatá).

2. RESTAVRACIJA PREPARACIJE Restaravaci obravnave inlejev a nje v skladu z navodili proizvajalca.

3. AKTIVACIJA KAPSULE I MIEŠANJE a) Pre aktiviranja, protesi ili jednom stranom udariti o tvrdú površinu kako bi se oslobodio prah (Silka 1).

b) Da aktivirati kapsulu pripraviť bat do konca v kapsulo, da je poranan v očíhš kapsule in držte 2 sekundy (Silka 2).

Opozorilo: 1) Zagotovite da je bat potpuno istisnut da se izbegne nepravilan odnos mešanja praha i tečnosti.

2) Kapsulu treba aktivirati tek neposredno pre mešanja i obojima.

c) Tako j u vstavite u mešalac (ili amalgamator) i mešajte 10 sekundi (+/- 4.000 obratova u minutu) (Silka 3).

Zoznamka: Se uporabljate rotacijski mešalec, uporaba centrifuge ni priporočljiva.

4. DOZIVANJE a) Zamešano kapsulo odmah izvaditi iz mešalca i postaviti je u aplikator GC CAPSULE APPLIER.

b) Naredite kapsulu, tako da pripravite kapsulu (Silka 4). Za namještanje smeru vaha, aplikator s kapsulom držite prema sebi i okrenuti telo kapsule.

c) Cement istisnuti direktno u preparaciju (Silka 5).

d) Za odstranjenje korišćene kapsule pritisnuti gumbo za oslobodjenje na aplikatoru. Okrenuti kapsulu i povući prema gore.

5. CEMENTOVANIE a) Notranje površine restaracije prevažite z zadostno količino cementa i odmah postaviti. Radno vreme znozn 2 minute od začatka mešanja pri 23°C (73°F). Vyššia teplota skracuje radno vreme.

b) Zoznamka: Kompleksnejši postopki zahtevajo daljšo radno vreme, preporučuje čuvati kapsule u frižideru i originalnoj alumínovoj foliji.

c) Zadržite zmešani pritisk.

d) Čas odstranite zaprte kapsule, ako je postojano gumjasti (Silka 6).

e) S každo obdelavo lahko začne 4 minuty in 15 sekúnd nakon postavljanja protetskog rada.

ČUVANJE

Za optimalno korišćenje preporučuje se kapsule čuvati u originalnoj alumínovoj foliji ali hladnom i tamnom mestu u 4-25°C (39-77,0°F).

BOJE

Zuba (Vita® boje) Vita® je tovarniški zaščitni znak Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemčija.

PAKIRANJE

50 kapsula Povrchová vzebnia kapsule: 0,36 g práhu in 0,18 g

Prior to use, carefully read the instructions for use.



GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

TOOTH CONDITIONING AGENT

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

GC Fuji PLUS CONDITIONER is a tooth conditioning agent designed for use with GC Fuji PLUS glass ionomer luting cement. It helps to enhance the bond between GC Fuji PLUS and tooth structure.

DIRECTIONS FOR USE

- After tooth preparation, apply GC Fuji PLUS CONDITIONER to the bonding surface for 20 seconds using a cotton pellet or sponge.
- Rinse thoroughly with water and dry. DO NOT DESICCATE.
- Proceed according to GC Fuji PLUS directions.
- Close the bottle immediately after use.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).

PACKAGES

Bottle of 7 g (6.5 mL)

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, flush immediately with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride. Not recommended for use with products that contain Epinephrine, which is known to react with iron containing products and may stain oral tissue.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
- In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

https://www.gc.dental/europe
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERGE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 06/2024

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.



GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

ЗЪБЕН КОНДИЦИОНИРАЦ АГЕНТ

Да се използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

GC Fuji PLUS CONDITIONER е зъбен кондициониращ агент, предназначен за употреба с глас-иономерния цимент за циментиране GC Fuji PLUS. Подобрява свързането на GC Fuji PLUS към зъбните структури.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

- След препарирането на зъба, нанесете GC Fuji PLUS CONDITIONER, с памучен тулфер или гъбичка към повърхностите, подлежащи на съхраняване за 20 секунди.
- Промийте обилно с вода и подсушете. НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ.
- Продължете, съобразно инструкциите за употреба на GC Fuji PLUS.
- Затворете шишенцето, веднага след употреба.

СЪХРАНЕНИЕ

За оптимална ефективност е препоръчително, съхранявайте при температура 4-25°C (39,2-77,0°F).

УПАКОВКИ

Бутилка 7 g (6,5 mL)

ВНИМАНИЕ

- В случай на контакт с оралните тъкани или кожа, промийте веднага с вода.
- В случай на контакт с метална съдържащи продукти и могат да оцветят оралните тъкани.
- Лични предпазни средства (ППЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
- В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои пациенти. При такива реакции, прекратете употребата и потърсете лекарска помощ.

Някои продукти, споменати в настоящата ИЗУ могат да бъдат класифицирани като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните листове за безопасност, налични на:

https://www.gc.dental/europe
Те също могат да бъдат поръчани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикетата за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ПОТАПАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати изсъхване и натрупване на замърсители.
Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекции средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните изчисления.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 06/2024

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.



GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

PROSTŘEDEK NA KONDICIOVÁNÍ ZUBU

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽÍTI

GC Fuji PLUS CONDITIONER je prostředek na kondicionování zubu pro použití se skloionomerním fixačním cementem GC Fuji PLUS. Pomáhá k zesílení vazebné síly mezi GC Fuji PLUS a zubní strukturou.

NÁVOD K POUŽÍTÍ

- Po přípravě zubu aplikujte GC Fuji PLUS CONDITIONER na spojovací plochy po dobu 20 sekund za použití bavlněného tamponu či houbičky.
- Důkladně opláchněte vodou a osušte.
- NEPŘESUŠUJTE.
- Postupujte podle návodu k GC Fuji PLUS.
- Lahvičku zavřete ihned po použití.

SKLADOVÁNÍ

Pro dosažení optimálního výsledku skladujte při teplotě 4-25°C (39,2-77,0°F).

BALENÍ

Lahvička 7 g (6,5 mL)

UPOZORNĚNÍ

- V případě kontaktu s ústní sliznicí či kůží místo okamžitě opláchněte vodou.
- V případě kontaktu s očima ihned propláchněte vodou a vyhledejte odborného lékaře.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER obsahuje 2% chlorid železitý. Není tedy doporučeno používat v kombinaci s produkty obsahujícími epinefrin, který je známý reakcí na produkty obsahující železo. Mohlo by tak dojít k pořísnění tkáňé dutiny ústní.
- Vždy používejte ochranné pomůcky jako rukavice, roušku a ochranný kryt očí.
- V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány podle GHS jako nebezpečné. Vždy se seznáme s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:

https://www.gc.dental/europe
Můžete se také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE OPAKOVANÉ POUŽÍVÁNÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Znehodnotte, pokud došlo k poškození dávkovacího systému.
NEPONORUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém.
Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřícímu úřadu ve vaší zemi, který je přístupný u následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Posledně upravené: 06/2024

Prije uporabe pažljivo pročitati upute za uporabu.



GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

SREDSTVO ZA KONDICIONIRANJE ZUBI

Samo za stručnu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE ZA UPORABU

GC Fuji PLUS CONDITIONER je sredstvo za kondicioniranje zubi namijenjeno za uporabu sa staklenoionomernim cementom GC Fuji PLUS. Pomaže poboljšati spajanje cementa GC Fuji PLUS i zubnog tkiva.

UPUTE ZA UPORABU

- Nakon preparacije zuba komadićem vate ili spužvicom nanijeti GC Fuji PLUS CONDITIONER na površinu za spajanje u trajanju od 20 sekundi.
- Temeljito isprati vodom i osušiti. NE PRESUŠITI.
- Nastaviti sukladno uputama za GC Fuji PLUS.
- Pažljivo zatvoriti odmah nakon uporabe.

ČUVANJE

Za optimalno korištenje preporučuje se Čuvati na temperaturi od 4-25°C (39,2-77,0°F).

PAKIRANJE

Bočica od 7 g (6,5 mL)

UPOZORENJE

- U slučaju dodira sa sluznicom ili kožom, odmah isprati vodom.
- U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER sadrži 2% željezo-klorida. Ne preporuča se koristiti ga u kombinaciji s proizvodima koji sadrže epinefrin, za kojeg je poznato da reagira s proizvodima koji sadrže željezo i može doći do obojenja sluznice.
- Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska i rošćku u sigurnosna zaštitna za oči, treba uvijek nositi.
- U rijetkim slučajevima ova proizvod može uzrokovati citivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije valja prekinuti s uporabom proizvoda i obratiti se liječniku.

Neki proizvodi navedeni u aktualnim uputama za uporabu mogu se klasificirati kao opasni sukladno Globalno usklađenom sustavu razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS).
Uvijek se treba upoznati sa sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na:
https://www.gc.dental/europe
Mogu se zatražiti i od dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA OPAKOVANÉ POUŽÍVÁNÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: kako bi se izbjeglo onečišćenje između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakiranja zahtijevaju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu napravu odbaciti.
NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo sušenje i nakupljanje onečišćenja.
Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranoj zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno/nacionalnim smjernicama.

Izješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj čete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 06/2024

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen!



GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

FOGKONDITIONÁLÓ ANYAG

Felhasználása csak szaképzett fogászati személyzetnek javasoljuk az indikációs területeken.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A GC Fuji PLUS CONDITIONER egy fogfészín-kondicionáló anyag, mely kifejezetten a GC Fuji PLUS üvegiomern ragasztócementtel történő alkalmazáshoz lett kifejlesztve. Az anyag tökéletesíti a kötést a GC Fuji PLUS és a fog szerkezete között.

HASZNÁLATI ÚTUTMÁTÓ

- A preparációt követően egy vattagombóc vagy szivacs segítségével vigyen a rögzítési felszínre GC Fuji PLUS CONDITIONER-t 20 másodpercere.
- Alaposan öblítse le vízzel. NE SZÁRÍTSA TELJESEN SZÁRÁZRA.
- Végezze el a ragasztást a GC Fuji PLUS használati útmutatójának megfelelően.
- Használat után az üveget azonnal zárja vissza.

TÁROLÁS

Az optimális teljesítmény eléréséhez 4-25°C (39,2-77,0°F) közötti hőmérsékleten tárolandó.

KISZERELÉS

Flakon 7g (6,5mL)

FIGYELMEZTÉS


- Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.
- Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.
- A GC Fuji PLUS CONDITIONER 2% vas-kloridot tartalmaz. Használatán nem javasolt Epinephrine tartalmú anyagok alkalmazásakor, melyek reakcióba lépnek a vassal és elszűnhetnek a nyálkahártyán.
- Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, biztonsági szemvédőt.
- A termék ritkán érzékenységi reakcióit válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlótl tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.

Némely termék, amire jelen útmutatóban hivatkozunk, a GHS besorolása szerint veszélyes lehet. Kérjük, mindig tájékozódjon a z alábbi oldalakon elérhető biztonsági adatlapok beszerkedőjétől is beszerezhetők.
https://www.gc.dental/europe
A biztonsági adatlapok kereskedőjétől is beszerezhetők.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS TÖBBSZÁLIS KISZERELÉS: a páciensek közti keresztfertőzések elkerülésének érdekében ez az eszköz közepes szintű dezinfekcióit igényel. A használat után azonnal ellenőrizze az eszköz és a címke sértetlenségét. Amennyiben sérült dobják ki.
NE MERÍTSE FOLYADEKBA. Alaposan tisztítsa meg az eszközt a szennyeződések megtapasdásának vagy rászáradásának elkerülésére.
Fertőtlenítse egésszégügyben regisztrált közepes szintű infektóikontrol csoportba tartozó termékkel, a regionális/ nemzeti előírásoknak megfelelően.

Nem kívánt hatások jelzése:
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakcióit vagy hasonlótl észel a termék használatá eredményeként, olyat is ami nem szerepel a használati utasításban találhat a felsorolásban, kérjük jelentsé közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az alábbi linken tudja kiválasztani az Ön országának megfelelő hatóság elérhetőségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjük, jelentsé az esetet a saját, belső figyelmeztető szolgálatunknak is: vigilance@gc.dental
Ezáltal hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos használatának javításához.

Utoljára módosítva: 06/2024

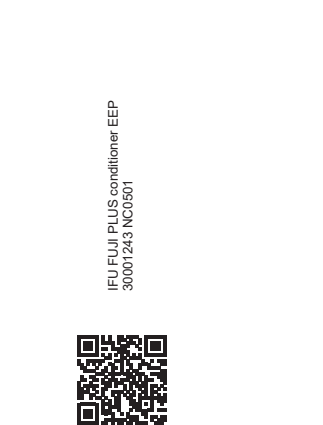

IFU FUJI PLUS conditioner EEP
30001243 NC0501

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania.



GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

ŚRODEK KONDYCYJONUJĄCY ZĘBY

Do stosowania wyłącznie przez dentystyczny personel medyczny zgodnie z zalecanymi wskazaniami.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

GC Fuji PLUS CONDITIONER jest środkiem kondycjonującym zębų przeczyszczającym do stosowania

z cementem glosjonomerowym do osadzenia GC Fuji PLUS. Pomaga zwiększyć siłę połączenia GC Fuji PLUS z tkanką zęba.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Po preparacji zęba nałożyć na 20 sekund GC Fuji PLUS CONDITIONER przy użyciu wacika lub gąbki.
- Spłukać dokładnie wodą i osuszyć. NIE PRZESUSZYĆ.
- Postępować zgodnie z instrukcją GC Fuji PLUS.
- Bezpośrednio po użyciu butelkę zakręcać.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zalecany w celu uzyskania optymalnego rezultatu, przechowywać w temperaturze 4-25°C.

OPAKOWANIA

Butelka 7g (6,5mL)

SRODKI OSTROŻNOŚCI

- W przypadku kontaktu z błoną śluzową lub skórą, spłukać niezwłocznie wodą.
- W przypadku kontaktu z gałką oczną, natychmiast spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem specjalistą.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER zawiera 2% chlorek żelaza. Niewskazane jest stosowanie z preparatami zawierającymi adrenaline, gdyż może to spowodować przebarwienia błony śluzowej.
- Zawsze powinny być używane środki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak rękawice, maski i okulary ochronne.
- Mindig viseljen személyi védőfelszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, biztonsági szemvédőt.
- A termék ritkán érzékenységi reakcióit válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlótl tapasztal, fuggessze fel a termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania mogą być klasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze należy zapoznać się z kartami charakterystyki dostępnymi na stronie:
https://www.gc.dental/europe
Można je również otrzymać od dostawcy.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UŻYCIA: Aby uniknąć krzyżowego zakażenia między pacjentami należy poddawać produkt dezynfekcji na średnim poziomie. Aby uniknąć krzyżowego zakażenia między pacjentami wyrób wymaga dezynfekcji średniego stopnia. Bezpośrednio po użyciu produkt oraz etykietę należy badać pod kątem uszkodzenia. Wyrzucić produkt w razie stwierdzenia uszkodzeń.
NIE ZANURZAJ W ŚRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Dokładnie oczyść produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substancji zanieczyszczających.
Dezynfekcję wykonywać dopuszczonym do stosowania środkiem klasy medycznej do zapobiegania infekcją zgodnie z wytycznymi regionalnymi/krajowymi.

Raportowanie działań niepożądanych:
Jeśli zauważyysz jakiegokolwiek niepożądane działanie, reakcję lub doświadczysz podobnych zdarzeń po zastosowaniu tego produktu, uwzględniając takie, które nie zostały wymienione w tej instrukcji stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej jednostce monitorowania, wybierając właściwy organ w Twoim kraju dostępny za pośrednictwem poniższego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Jako również do naszej wewnętrznej jednostki monitorowania: vigilance@gc.dental
W ten sposób przyczynisz się do poprawy bezpieczeństwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 06/2024



IFU FUJI PLUS conditioner EEP
30001243 NC0501

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.



GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

AGENT DE CONDITIONARE

A se utiliza doar de către profesioniștii din domeniul stomatologic conform indicațiilor de folosire.

INDICAȚII DE UTILIZARE

GC Fuji PLUS CONDITIONER este un agent de condiționare realizat pentru a fi folosit împreună cu cimentul ionomer de sticlă pentru cimentare GC Fuji PLUS. Ajută la întărirea legăturii dintre GC Fuji PLUS și structura dintelui.

INDICAȚII DE FOLOSIRE

- După pregătirea dintelui, aplicați GC Fuji PLUS CONDITIONER pe suprafața bontului timp de 20 de secunde folosind o buletă sau un burete.
- Clătiți bine cu apă și uscați. NU DESICATAȚI.
- Continuati urmând instrucțiunile de folosire ale GC Fuji PLUS.
- Închideți sticla imediat după utilizare.

DEPOZITARE

Pentru o performanță optimă, depozitați la temperatura între 4-25°C (39,2-77,0°F).

AMBALARE

Sticlă de 7 g (6,5 mL)

ATENȚIE

- În cazul contactului cu țesutul bucal sau cu pielea, clătiți imediat cu apă.
- În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă și consultați un medic.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER conține 2% Clorură Ferică. Nu este recomandată utilizarea în combinație cu produse care conțin Epinefrină, deoarece aceasta reacționează la contactul cu produse care conțin fier și poate păta țesutul oral.
- Țăchiplamentul personal de protecție cum ar fi mănuși, mască și ochelari de protecție trebuie utilizat întotdeauna.
- În cazul rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite persoane. Dacă apar astfel de reacții, încetați utilizarea produsului și adresați-vă unui medic.

Anumite produse menționate în aceste Instrucțiuni de Folosire pot fi clasificate ca fiind periculoase conform GHS.
Familiarizați-vă întotdeauna cu fișele cu date de siguranță disponibile la:
https://www.gc.dental/europe
Pot fi obținute deasemenea de la distribuitorul dumneavoastră.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE RECIPIENTE DESTINATE UTILIZĂRILOR MULTIPLE: pentru a se evita contaminarea Incrucați între pacienți acest dispozitiv necesită un nivel mediu de dezinfectare. Imediat după utilizare inspețați recipientul și eticheta pentru a observa dacă au suferit deteriorări. În cazul în care recipientul este deteriorat, renunțați la utilizarea sa.
A NU SE SCUFUNDA ÎN SOLUȚIA DEZINFECTANTĂ. Curățați dispozitivul pentru a preveni uscarea și acumularea de substanțe contaminante.
Dezinfectați cu un produs medical autorizat pentru prevenirea și controlul infecțiilor de nivel mediu în conformitate cu reglementările naționale/regionale.

Raportarea efectelor nedorite:
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, reacții adverse sau evenimente similare ca urmare a utilizării acestui produs, inclusiv a celor neincluse în aceste instrucțiuni de folosire, vă rugăm să le raportați direct către sistemul de control competent, relevant, prin selectarea instituției corespunzătoare din tara dumneavoastră din lista disponibilă în link-ul următor:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
precum și către sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental
În acest fel veți contribui la îmbunătățirea siguranței oferite de acest produs.

Revizuit ultima dată: 06/2024

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением.



GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

ДЖИ СИ Фуджи ПЛЮС КОНДИЦИОНЕР

РАСТВОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО СЛОЯ

Для использования только специалистом-стоматологом в соответствии с показаниями к применению.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
GC Fuji PLUS CONDITIONER является раствором для удаления загрязняющего слоя, разработанным для

применения в комбинации со стеклоиономерным фиксирующим цементом GC Fuji PLUS. Раствор помогает усилить адгезию GC Fuji PLUS к твердым тканям зуба.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1) После препарирования зуба нанесите GC Fuji PLUS CONDITIONER на рабочую поверхность на 20 секунд с помощью ватного тампона или

Prior to use, carefully read the instructions for use.



GC Fuji PLUS™ EWT

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT WITH EXTENDED WORKING TIME

Use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

- Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns and bridges
- Cementation of resin inlays, onlays, crowns and bridges
- Cementation of all ceramic inlays
- Cementation of high strength (zirconia based) all ceramic crowns and bridges
- Cementation of metal, ceramic and fibre based

CONTRAINDICATIONS

- Direct pulp capping
- Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylic monomer or methacrylic polymer.

COMPOSITION
Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, initiator, pigment
Liquid: Methacrylate, water, polyacrylic acid, dimethacrylate, carboxylic acid, stabilizer.

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid Ratio (g/g)	2.0/1.0
Mixing Time (sec.)	30*
Working time (min., sec.) (at 23 °C) (from start of mixing)	20*
Setting Time (37°C/99°F) (min., sec.)	5'45"

Radio-opaque: Its radiopacity is equivalent to 2.1 mm or 210% aluminum. (The radiopacity of aluminum is comparable to dentin.)

- ISO 9117-2 Class 1, Luting

1) TOOTH PREPARATION

- Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide.
- Clean the prepared teeth with pumice and water.

- Use GC Fuji PLUS CONDITIONER on the prepared tooth surface for 20 seconds for optimal adhesion.
- Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT RESCOTCH. Prepared surface should appear moist (glistening).

2) RESTORATION PREPARATION

Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.

POWDER AND LIQUID DISPENSING

Note: Use GC Fuji PLUS Liquid. Refer to the instructions for use of GC Fuji PLUS.

- The standard powder to liquid ratio is 2.0g / 1.0g (1 level large scoop of powder to 3 drops of liquid, or 1 level small scoop of powder to 1.5 drops of liquid).
- For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert.
- Use the liquid bottle vertically and squeeze gently.
- Close bottles immediately after use.

- Dispense powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, add all the powder to the liquid. Mix rapidly for 20 seconds. Note: When using larger amounts, divide the powder into 2 equal parts. Mix the first portion with all of the liquid for 15 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole thoroughly for 15-25 seconds (total 30-40 seconds).

- CEMENTATION**
 - Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seal immediately. The working time is 3 minutes 30 seconds after start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will shorten working time.
 - Use moderate pressure.
 - Start removing excess cement when the excess cement feels rubbery.
 - Finishing can be started 5 minutes 45 seconds after sealing the restoration.

STORAGE
For optimum for optimal performance, store in a cool and dark place (25°C) (39.2-77.0°F).

SHADES

A3 (Vita® shade)
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGE

Powder 15g with scoop

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton swab in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- DO NOT mix powder or liquid with components of other glass ionomer cements.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride. It is not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with products containing Epinephrine as this may stain oral tissue.
- Do not use GC Fuji PLUS EWT in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC Fuji PLUS EWT from setting or bonding properly.
- This product is not indicated for filling or core build-up.
- In any case the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazard-ous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gorepore.com> They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERSÉ. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazard-ous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gorepore.com> They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or <https://ec.europa.eu/health/eu/med-devices/vigilance/gcc-dental-in3-way> you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 12/2023

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country according to the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en or

GC Fuji PLUS™ Prior to use, carefully read the instructions for use.



GC Fuji PLUS™

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

- Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns and bridges
- Cementation of resin inlays, onlays, crowns and bridges
- Cementation of all ceramic inlays
- Cementation of high strength (zirconia based) all ceramic crowns and bridges
- Cementation of metal, ceramic and fiber posts

CONTRAINDICATIONS

- Do not use this product on patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer.

COMPOSITION

Prášek: Fluoro-alumino-silikátové glass, Initiator, pigment
Lichid: Methacrylate, voda, polyacrylic acid, dimethacrylate, carboxylic acid, stabilizer.

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid ratio (g/g)	2,0/1,0
Mixing time	20"
Working Time (23°C / 73°F) (min., sec.)	2'30"
Setting Time (37°C/99°F) (min., sec.)	4'30"

ISO 9917-2 Class 1, Luting
Radio-opaque: Its radiopacity is equivalent to 2.1 mm or 210% aluminum. (The radiopacity of aluminum is comparable to dentin.)

- TOOTH PREPARATION**
 - Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide.
 - Clean the prepared tooth with pumice and water.
 - Use GC Fuji PLUS CONDITIONER on the prepared tooth surface for 20 seconds for optimal adhesion.
 - Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATÉ. Prepared tooth surface must be completely dry.
- RESTORATION PREPARATION**

Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the instructions of the manufacturer.

- POWDER AND LIQUID DISPENSING**
 - The standard powder to liquid ratio is 2.0 g / 1.0 g. (1 level large scoop of powder to 3 drops of liquid, or 1 level small scoop of powder to 1 drop of liquid)
 - For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert.
 - Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.
 - Close bottles immediately after use.
- MIXING**
 - Dispense powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, add all the powder to the liquid. Mix rapidly for 20 seconds.
 - Note: When mixing larger amounts, divide the powder into 2 equal parts. Mix the first portion with all of the liquid for 15 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole thoroughly for 15-25 seconds (total 30-40 seconds).
- CEMENTATION**
 - Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and start mixing immediately. The working time is 2 minutes 30 seconds from onset of mixing at 23°C (73°F).
 - Higher temperature will shorten working time.
 - Note: For more complex procedures requiring longer working time, it is recommended to mix powder and liquid on a cold mixing slab and to use GC Fuji PLUS EWT.

- Maintain moisture**
 - Start removing excess cement when the excess cement feels rubbery.
 - Finishing can be started 4 minutes 30 seconds after seating the restoration.
- STORAGE**

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (-4±25°C) (39-77.0°F).
- SHADES**

Yellow, A3 (Vita® shade), Translucant Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGES
1) 1-1 package: 15 g powder, 8 g (7 mL) liquid, GC Fuji PLUS 2) CONDITIONER 7 g (6.5 mL), a double-ended powder scoop, a plastic spatula, mixing pad (#23)
3) Powder 15 g with scoop
4) Liquid 8 g (7 mL)
5) GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6.5 mL)

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/ or COCOABUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

- DO NOT mix powder or liquid with components of other glass ionomer cements. GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride.
- It is not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with products containing Euphratine as this may stain oral tissue.
- Do not use GC Fuji PLUS in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC Fuji PLUS from setting or bonding properly.
- This product is not indicated for filling or core build-up.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IUP may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
https://www.gc.dental/europe
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSÉ: Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.
For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.
Last revised: 05/2024

GC Fuji PLUS™

РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН ПОДСИЛЕН ГЛАС-ИОНОМЕР ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ

Da se izpolzava samo ot dentalni lekarji, spazivajki instrukcije za upotrebu.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Циментирање на метал, онлај, корона и мостове с метална основа.
- Циментирање на резин инлај, онлај, корона и мостове.
- Циментирање на цело керамички инлај.
- Циментирање на високо керамички корона и мостове от високо учествоња (на зракима (аргонумев).
- Циментирање на метални, керамички и фибро-цифтове.

КОНТРАИДИКАЦИИ

- Директно пуљно покрите.
- Изабегнување употреба на този продукт при пациенти с известни алергии към глас-иономерни цемент, метакрилатен мономер или метакрилатен полимер.

СЪСТАВ

Прашек: Флуоро-алумино-силикатно стакло, иницијатор, пигмент
Течност: Метакрилат, вода, Полиакрилова киселина, Диметакрилат, Карбоксилска киселина.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

Својотеначење практичноста (g/g)	2,0/1,0
Време за смесвање (сек.)	20"
Време за работа (при 23°C) (мин.сек.)	2'30"
време за втврдување (37°C/99°F) (мин.,сек.)	4'30"

ISO 9917-2 Клас 1 / Циментирање
Радио-опакот: Радо-опакот е еквивалентна с 2,1 мм или 210% алуминиј. (Радио-опакоста на алуминија е сравнима с теми на дентина.)

- ПОДГОТВЕ НА ЗЪБА**
 - Подгответе зъб по обичајната начин. За покривање на пултата, изолгавате калциева хидроксид.
 - Поместете препарираниа зъб с лемаз и вода.
- ЗАБЕЛУКА:**

За оптимална адхезија, нанесете GC Fuji PLUS CONDITIONER върху површината на подготвения зъб преку 20 секунди.
- ПРОМИТЕ ОБИЧНО С ВОДА:**

Отстранете излишната влага преку издување с памучен туфтер или с лева вдушна струја. НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ.

ПОДГОТВЕ НА ВЪЗСТАВОВАНИЕТО

Уверете се, че възстановяването е подготвено и гетрирано съобразно инструкциите на производителя.

- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАХЪТ/ТЕЧНОСТ**
 - Стандартното съотношение прах : течност е 2,0/1,0 g
 - Смесете прахта част от праха с четката тежестно в продължение на 15 сек.
 - Разклатете и разбъркайте праха със 3 капки от течността, или 1 малка равна лъжичка прах към 1 капка от течността.
 - За прецизно дозирање на праха, леко почукайте шипенцето в ръка. Не го разклатете или обръщайте.
 - Дръжте буталката с течността вертикално и стиснете леко.
 - Затворете буталката веднага след употреба.
- ЦИМЕНТИРАНЕ**

Разпределете прах и течност върху површината. Използвайте пластмасова шпатула, прибавяте целия прах към течността. Разбъркайте съставеното (total 30-40 секунди).

Забелюка:
Когато смесвате голямо количество разредете праха на две равни части. Смесете прахта част от праха с четката тежестно в продължение на 15 сек. Добавете и останалата част и смесете цялото око 15-20 сек. (Общо време за смесвање 30-40 сек.)
- ЦИМЕНТИРАНЕ**
 - Покрийте външната површина на възстановяването с достатъчен прах и течност и веднага поставете възстановяването. Времето за работа е 2 минути и 30 секунди от началото на смесването при 23°C (73°F).
 - При високи температури ще съкратят времето за работа.
- ЗАБЕЛУКА:**

При по-сложни процедури, изкозаваша по-дълго време за работа е препоръчително да разбъркате прах и течността върху изстудена плочка или използвате GC Fuji PLUS EWT.
- ЗАПОМНЕТЕ**
 - Започнете отстраняването на излишната цемент, когато стане мусковобразен.
 - Финираното може да започне 4 минути и 30 секунди след поставяњето на възстановяването.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимални резултати се препоръчва съхраняваите на хладно и тъмно място (4±25°C) (39,2-77,0°F).

ЦЕЛОВОЕ

Желт, А3 (по разцветката на Vita®), Транслучент Vita® е регистрирана търговска марка на Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

ОПАКОВКИ

- 1-1 опаковка: 15 g прах, 8 g (7 mL) течност, GC Fuji PLUS 2) CONDITIONER 7 g (6.5 mL), двустранна мерилна лъжичка, пластмасова шпатула, смесително ложко (#23)
- Прах 15 g с мерилна лъжичка
- Течност 8 g (7 mL)
- GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 g (6.5 mL)

ВНИМАНИЕ

- В случаи на контакт с органите тъкани или кожа, премажете веднага с памучен туфтер наложен в алкохол. Промийте обично с вода. За да избегнете контакт, може да използвате COCOA BUTTER на изолирано операционно поле от кожата или органите тъкани.
- В случаи на контакт с очите, промийте веднага обично с вода и потърсете медицинска помощ.
- НЕ смесвайте праха или течността с други глас-иономерни компоненти.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER съдържа 2% железен хлорид.
- Не се препоръчва употребата на GC Fuji PLUS CONDITIONER в комбинация с продукти съдържащи Адриленит (Епинедрин), тъй като може да се осветят органите тъкани.
- Не използвайте GC Fuji PLUS в комбинация с еugenol съдържащи материали, тъй като еugenol може да наруши нормалното втврдување и свързване на GC Fuji PLUS.
- Този продукт не е показан за обуржани или изградени.
- Лични предпазни средства (ПЕ) като ризициви, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
- В реди случаи, продуктът може да предизвика суровостичност у някои пациенти. При такова реакция, прекратете употребата и потърсете лекарска помощ.

Некои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност на всички на:
https://www.gc.dental/europe

POЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФИКАЦИЯ:
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избягне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за впоаване на състоянието. Измеряйте устройството, ако е уредено.

НЕ ПОТАПАЙТЕ: Поместете добре устройството, за да се предотврати изсушване и нарушавне на змърсяности.
Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, а в зависимост от регионалните / националните указания.

За Разумење на безопасността и клиничното представяне (SSCP), моля, вижте базата данни EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узмете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ли директно чрез съветвателна система за безпечност, която избереете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en както и на нашата страна за външна безпечност:
vigilance@gc.dental

По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.
Последна редакция: 05/2024

GC Fuji PLUS™

RADIOPAKNI ZESIŠENÝ SKLOIONOMERNÍ FIKÁČNÍ CEMENT

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE K POUŽITÍ

- Cementování všech typů kovových inlaj, onlaj, korunek a můstků.
- Cementování kompozitních inlaj, onlaj, korunek a můstků.
- Cementování puníh keramických inlaj.
- Cementování všech keramikových korunek a mostův z vysoké pevnosti (na zřetelna (argonumev).
- Cementování kovových a keramických čepů, i čepů ze skelného vlákna.

KONTRAINDIKACE

- Přírné pokrývání pulpy.
- Ížaběznité užití produktu u pacientů se znáanou alergií na skloionomerní cement, metakrylátový monomér nebo metakrylátový polymer.

SLŐŽENÍ

Prášek: Fluor-hliniko-silikátové sklo, iniciátor, pigment
Tekutina: Methakrylát, Destilovaná voda, Kyselina polyakrylová, Dimethakrylát, Karboxylová kyselina.

NÁVOD K POUŽITÍ

Prášek / tekutina poměr (g/g)	2,0/1,0
Míchací čas (sek.)	20"
Pracovní čas (př 23°C) (min., sek.)	2'30"
čas tuhnutí (37°C/99°F) (min., sek.)	4'30"

ISO 9917-2 Třída 1 / Fikáční
Radio-opak: 2,1 mm-és vagy 210%-os alumíniummal egyenértékű a sugárzástűrő képessége. (Az alumínium sugárzástűrő képessége a dentinéhoz hasonló.)

- PŘÍPRAVA ZUBU**
 - Zub připravit na obložběním zátka. Za překrývání pulpy použijte hydroxid kalcium-hydroxid.
 - Zub očistit pískem i vodou.
- POČÍTEJTE PRÁŠEK I TEČNOST:**

Pro optimální adhezi, naneste GC Fuji PLUS CONDITIONER na povrch zubu a traujajte od 20 sekund k zesilení adheze.
- PŘÍPRAVA PROTĚTSKOG RADU:**

Prášek tekutinu staví na podkladu za měšání. Plastickou špatulou dodat sav prášek a tekutinu. Měšajte bž 20 sekund.

- DOZIRANIE PRAŠKA I TEČNOSTI**
 - Standardní oměr praška i tekutiny iznosi 2,0 g / 1,0 g. (Táka se konzistencia je jednaka jedinstvenom velikom žlicom praška i 1 kapki tekućine. Za marje inelje i sJ, uzima se jedna mala žlica praška i jedna kap tekućine.)
 - Pro přesné doziranje praška počuju lagaku lupnutí od dlan. Ne tresi ih prekratit.
 - Uvažujte mrvljak i vodu, a držite lahvičku uspravno i zatvorite poklopac.
 - Držite lahvičku s tekućinom vertikalno i lake stisnite.
 - Uzavajte lahvičku ihned po podžiti.
- MJEŠANJE**

Kod većeg količine praška dodajte na 2 jednaka dijela. Pri tome miješajte sa ovom tekutinom 15 sekundi. Dodati prostal prašek i sve zajedno miješajte još 15-25 sekundi (ukupno 30-40 sekundi).

- CEMENTIRANJE**
 - Unutrašnju površinu nadomjestka premazati dovoljnom količinom cementa i odmah postaviti. Radno vrijeme iznosi 2 minute i 30 sekundi od početka miješanja praška i tekućine pri 23°C (73°F). Više temperature skraćuju radno vrijeme.
 - Pažnja:
Za cementiranje većeg vremena koji zahijevaju više praška i tekućine, preporuča se miješati prašek i tekutinu na hladnoj podlozi ili koristiti GC Fuji PLUS EWT s produženim radnim vremenom.
 - Zadržati uzimati priklad.
 - Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštitna za oči, treba uvijek nositi.
 - Začinčaje s odstranjenim prethodnoči zrakom ad ziská ztk. „gumovoi konzistencii“.
 - Zaključivanje móže bý zahžjeno 4 minute 30 sekund po usazení náhrady.
- SKLADOVANÍ**

Pro optimální optimální výsledku skladujte na chladném a tmavém místě při teplotě (4±25°C) (39,2-77,0°F).

ODŠTNÍ

Žlutá, A3 (Vita® odstín), Translucentní Vita® je registrovanou ochrannou známkou Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo.

BALENÍ

- 1-1 balení: 15 g prašek, 8 g (7 mL) tekutina, GC Fuji PLUS 2) CONDITIONER 7 g (6.5 mL), dvostana žlička za prašek, plastická špatula, blok za mješání (#23)
- Prášek 15 g s žličkou
- Tečnina 8 g (7 mL)
- GC Fuji PLUS KONDICIONER 7 g (6,5 mL)

UPOZORNĚNÍ

- V případě kontaktu s kání dutými ušními nebo pokožkou odstraňte okamžitě kontamince bavlněným tamponem, očistě no hubičkou namočenou v lhu. Opláchněte vodou. Pro izolaci operčního pole lze použít COCOA BUTTER.
- V případě kontaktu s očima, odmah isprati vodou i potražiti lékařskou pomoc.
- NE miješajte prašek i tekutinu s drugim staklenomernim cementima.
- GC Fuji PLUS CONDITIONER sadrži 2% željezo-klorida. Ne preporučuje se koristiti s produžnim radnim vremenom.
- Nepoužívejte GC Fuji PLUS v kombinaci s materijalima koji sadrže eugenol, budući da eugenol može sprječati pravilno stvrdnjavanje ili spajanje GC Fuji PLUS.
- Eugenol može brániti fiksánuju tuhnuti a vazbaž GC Fuji PLUS.
- Tento produkt není indikován pro vyplněné nebo dočasně zavázané zuby.
- Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové masky a ochranné brýle.
- V jedinečném případě může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek by se neměl používat a měly být osloveny lékařské odborníky.

Některé výrobky, které jsou uváděny v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
https://www.gc.dental/europe
Takoder su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠTENIE I DEZINFEKČIA:
VIEŠKRÁTNO UPOTREBENIE IVA PAKIRANIE: kako bi se izbjego očešćenje između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledajte višekratno upotrebljiva pakiranja i označite očtećenja ako ih ima. Očestueu napravu odbačite.
NE URANJAJTI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU: Temeljito očistite višekratno upotrebljiva pakiranja kako bi se spriječio sušenje i nakupljanje očešćenja. Dezinficirajte sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranom zdravstveno-infekciji kontrolni sukladno regionalno/nacionalnim smjernicama.

ZA SAŽETAK SIGURNOSTI I KLINIČKE UČINKOVITOSTI (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Uvijek izvješćujte o neželjenim učincima.
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijaviš direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta i vašeg država, dostupno putem sljedeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kao i na našim internim sustav nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj će način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Tašno zpsobom pripisujete ke izvješće bezpечnosti tohoto produktu.

Posledné upravene: 05/2024

GC Fuji PLUS™

POJAČANÍ RENDGENSKI STAKLENONOMERNÍ CEMENT ZA CEMENTIRANJE

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama.

INDIKACIJE ZA UPORABU

- Cementiranje inlaja, onelja, krunica i mostova s metalnom osnovom.
- Cementiranje kompozitnih inlaja, onelja, krunica i mostova.
- Cementiranje punih keramičkih inlaja.
- Cementiranje svih keramičkih krunica i mostova (s osnovom iz cirkonija) velike čvrstoće (argonumev).
- Cementiranje metalnih, keramičkih i vlaknastih kočica.

KONTRAINDIKACIJE

- Direktno prekrivanje pulpe.
- Izbjegite korištenje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatim alergijama na staklenoionomerni cement, metakrilatni monomer ili metakrilatni polymer.

SASTAV

Prášek: Fluoro-alumino-silikatno staklo, Inicijator, Pigment
Tekućina: Metaklat, voda, Poliakrilna kiselina, Dimetakrilat, Karboksilna kiselina.

UPUTE ZA RAD

Omjer prašak / tekućina (g/g)	2,0/1,0
Vrijeme miješanja (g)	20"
Vrijeme rada (pri 23°C) (min., sek.)	2'30"
vrijeme stvrdnjavanja (37°C/99°F) (min., sek.)	4'30"

ISO 9917-2 Klasa 1 / Cementiranje
Radio-opak: 2,1 mm-és vagy 210%-os alumíniummal egyenértékű a sugárzástűrő képessége. (Az alumínium sugárzástűrő képessége a dentinéhoz hasonló.)

- PŘÍPRAVA ZUBA**
 - Zub připravit na obložběním zátka. Za překrývání pulpy použijte kalcij-hydroxid.
 - Zub očistiti pískem i vodou.
- POČÍTEJTE PRAŠEK I TEČNOST:**

Pro optimální adhezi, naneste GC Fuji PLUS CONDITIONER na površnu zubu a traujajte od 20 sekund k zesilení adheze.
- PŘÍPRAVA PROTĚTSKOG RADU:**

Prášek tekutinu staví na podkladu za mješání. Plastičnom špatulom dodati sav prašek i tekutinu. Měšajte bž 20 sekund.

- DOZIRANIE PRAŠKA I TEČNOSTI**
 - Standardní oměr praška i tekutiny iznosi 2,0 g / 1,0 g. (Táka se konzistencia je jednaka jedinstvenom velikom žlicom praška i 1 kapki tekućine. Za marje inelje i sJ, uzima se jedna mala žlica praška i jedna kap tekućine.)
 - Pro přesné doziranje praška počuju lagaku lupnutí od dlan. Ne tresi ih prekratit.
 - Uvažujte mrvljak i vodu, a držite lahvičku uspravno i zatvorite poklopac.
 - Držite lahvičku s tekućinom vertikalno i lake stisnite.
 - Uzavajte lahvičku ihned po podžiti.
- MJEŠANJE**

Kod većeg količine praška dodajte na 2 jednaka dijela. Pri tome miješajte sa ovom tekutinom 15 sekundi. Dodati prostal prašek i sve zajedno miješajte još 15-25 sekundi (ukupno 30-40 sekundi).

- CEMENTIRANJE**
 - Unutrašnju površinu nadomjestka premazati dovoljnom količinom cementa i odmah postaviti. Radno vrijeme iznosi 2 minute i 30 sekundi od početka miješanja praška i tekućine pri 23°C (73°F). Više temperature skraćuju radno vrijeme.
 - Pažnja:
Za cementiranje većeg vremena koji zahijevaju više praška i tekućine, preporuča se miješati prašek i tekutinu na hladnoj podlozi ili koristiti GC Fuji PLUS EWT s produženim radnim vremenom.
 - Zadržati uzimati priklad.
 - Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštitna za oči, treba uvijek nositi.
 - Začinčaje s odstranjenim prethodnoči zrakom ad ziská ztk. „gumovoi konzistencii“.
 - Zaključivanje móže bý zahžjeno 4 minute 30 sekund po usazení náhrady.
- SKLADOVANÍ**

Pro optimálne optimální výsledku skladujte na chladném a tmavém mjestu (-4±25°C) (39,2-77,0°F).

BOJE

Žutá, A3 (Vita® shade), Translucantní Vita® je zaštićen znak tvornice Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo.

PAKIRANJA

- 1-1-pakiranje: 15 g prašek, 8 g (7 mL) tekućina, GC Fuji PLUS 2) CONDITIONER 7 g (6.5 mL), dvostana žlička za prašek, plastična špatula, blok za mješanje (#23)
- Prášek 15 g s žličkom
- Tečnina 8 g (7 mL)
- GC Fuji PLUS KONDICIONER 7 g (6,5 mL)

UPOZORENJE

- U slučaju dodira s oralnim tkivima ili kožom, odmah odstraniti spužvom ili vatom namočenom u alkohol. Isprati vodom. Za izbjegavanje dodira s tkivima može se koristiti koferdam ili COCOA BUTTER za izolaciju radnog područja od kože ili oralnog tkiva.
- U

